

SRT-10/SRT-10C SEC 色谱柱

使用手册

色谱柱信息

SRT-10 以及 SRT-10C SEC 色谱柱键合固定相是采用专利的表面修饰技术，通过在高纯度具有良好机械稳定性的硅胶基质上键合均匀的纳米厚度亲水涂层而制备得到，粒径均为 10 μm 。独有的化学修饰技术可精确控制亲水涂层的厚度，从而确保柱与柱之间有着可靠的重现性。由于采用的独特化学键合技术，且涂层覆盖完全，因此 SRT-10 及 SRT-10C 具有优异的稳定性和分离效率。均匀的涂层保证了分离的高效性。SEC-100、SEC-300、SEC-500、SEC-1000 和 SEC-2000 填料为窄粒径分布的球形颗粒，孔径分别为 100 $\text{\AA}$ 、300 $\text{\AA}$ 、500 $\text{\AA}$ 、1000 $\text{\AA}$ 和 2000 $\text{\AA}$ 。精心设计的大孔体积保证了高的分离容量，从而具有优异的分辨率。SRT-10/SRT-10C 色谱柱采用专有的匀浆技术填充，以实现均匀稳定的填充床密度，从而实现最大的色谱柱效率。

SRT-10 和 SRT-10C SEC 固定相旨在确保在各种分离应用中保持高分辨率和最大回收率。应用领域覆盖了大分子量的生物分子（如蛋白质、核酸）、小分子量的生物分子（如多肽、寡核苷酸）、天然聚合物（如多糖）、合成聚合物、细菌、病毒、纳米材料（如纳米颗粒）等。SRT SEC 柱一般在缓冲溶液中进行样品的分离和检测。

色谱柱特征参数

硅胶：球形、高纯度（金属含量 < 10 ppm）

粒径：10 μm

孔径及适用分子量范围：

100 $\text{\AA}$ ，适用蛋白分子量范围 100 ~ 30,000

300 $\text{\AA}$ ，适用蛋白分子量范围 5,000 ~ 1,250,000

500 $\text{\AA}$ ，适用蛋白分子量范围 15,000 ~ 5,000,000

1000 $\text{\AA}$ ，适用蛋白分子量范围 50,000 ~ 7,500,000

2000 $\text{\AA}$ ，适用蛋白分子量范围 > 10,000,000

稳定性和性能

SRT-10 和 SRT-10C 色谱柱使用的是被完全覆盖的键合硅胶填料，因此具有优异的稳定性和性能。它与大多数缓冲液相容，如醋酸铵、磷酸盐、Tris 等。色谱柱在从出厂发货之前，使用 pH 7.0 的 150 mM 磷酸盐缓冲液进行质量控制（QC）。

图 1 显示了 7.8 $\times$ 300 mm SRT-10/10C SEC 色谱柱的

典型 QC 色谱图。流动相为 150 mM 磷酸钠缓冲液，pH 7.0，流速为 1.0 mL/min 和 UV 214 nm 检测。数据是在环境温度(23 $^{\circ}\text{C}$) 下以 10 μL 的进样量收集的。

中性亲水性 SRT-10 和 SRT-10C SEC 固定相，如 Zenix 和 SRT 树脂与生物分子（尤其是蛋白质）的非特异性相互作用可忽略不计，可以从分析柱无缝过渡到制备柱。

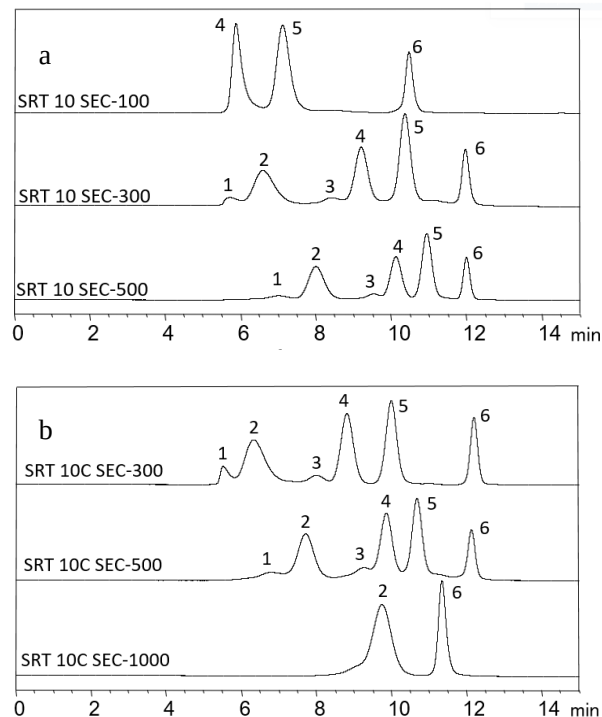


图 1. 蛋白混合物分离图谱，使用的色谱柱分别为(a) SRT-10 SEC-100, SRT-10 SEC-300, and SRT-10 SEC-500 以及(b) SRT-10C SEC-300, SRT-10C SEC-500, and SRT-10C SEC-1000。蛋白混合物：(1) 甲状腺球蛋白 (1.0 mg/mL)，670 kD；(2) 牛血清白蛋白二聚体，132 kD；(3) 牛血清白蛋白 (1.0 mg/mL)，66 kD；(4) 核糖核酸酶 A (1.0 mg/mL)，13.7 kD；(5) 尿嘧啶 (0.1 mg/mL)，120 D。

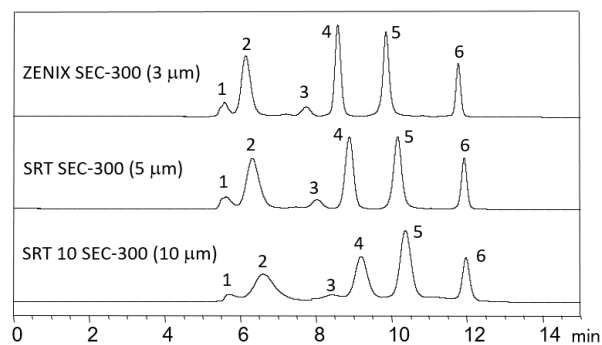


图 2. 蛋白混合物分离图谱，色谱柱规格为 7.8 $\times$ 300 mm，在 1 mL/min 流速下分析，紫外波长 214 nm。色谱峰分别为 (1) 甲状腺球蛋白聚集体，(2) 甲状腺球蛋白，(3) 牛血清白蛋白二聚体，(4) 牛血清白蛋白，(5) 核糖核酸酶 A，(6) 尿嘧啶。

图 2 显示了在 Zenix SEC-300 (粒径 3 μm)、SRT SEC-300 (粒径 5 μm) 和 SEC-10 SEC-300 (粒径 10 μm) 三种不同粒径色谱柱上进样的标准蛋白质混合物的洗脱曲线，C-line 系列色谱柱的洗脱曲线如图 3 所示。

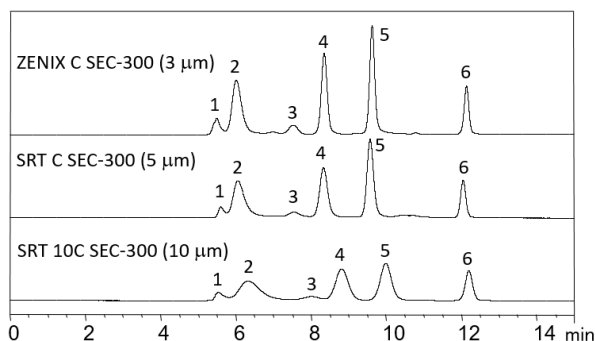


图 3. 蛋白混合物分离图谱，色谱柱规格为 7.8×300 mm，在 1 mL/min 流速下分析，紫外波长 214 nm。色谱峰分别为 (1) 甲状腺球蛋白聚集体，(2) 甲状腺球蛋白，(3) 牛血清白蛋白二聚体，(4) 牛血清白蛋白，(5) 核糖核酸酶 A，(6) 尿嘧啶。

安全注意事项

SRT-10 和 SRT-10C SEC 柱通常在中压下运行。如果管路连接不紧，将会导致有机溶剂和注入样品的泄漏，从而对操作人员的健康产生影响。一旦发生泄漏，应佩戴手套进行处理。色谱柱在高压下装入不锈钢硬件中，拆开过的色谱柱的性能无法保证，因而不建议打开色谱柱硬件。

样品与流动相

为了避免色谱柱的堵塞，所有样品和溶剂，包括缓冲溶液在内，都必须在使用前用 0.45 μm 或 0.2 μm 的滤膜过滤。SRT-10 和 SRT-10C 色谱柱可以使用水或有机溶剂和水的混合物，如乙腈和水。SRT-10 和 SRT-10C 色谱柱推荐流动相为 150 mM 磷酸缓冲液，pH 7.0。流动相在使用前需要脱气。常用脱气方法是将流动相超声处理 5 min。

色谱柱的保养

频繁更换有机相和水相缓冲液将会影响色谱填料性能以及色谱柱的使用寿命。由于流动相的粘度会影响色谱柱的反压，请根据流动相溶剂的粘度大小对流速进行适当调整。这样可以确保色谱柱分离性能的稳定性，不会出现色谱柱压力不稳定或者压力过高的情况。当从水相切换到有机相时，在其间运行至少 2-5 CV (Column Volume, CV) 的纯水，这样可以防止出现盐析/沉淀，避免色谱柱塌陷。此外，建议将色谱柱在纯水中的保留时间减至 5 CV，不

建议将色谱柱长期保存于纯水中。色谱柱需充分平衡后再进样，建议将色谱柱中液体置换成流动相后放置过夜或者使用测试流动相低流速过夜冲洗色谱柱。

Solvent	Viscosity at 20°C
Acetone	0.32
Acetonitrile	0.37
Methanol	0.55
Water	1.00
Ethanol	1.20
2-propanol	2.40

除了对样品和流动相进行过滤处理，更好的保护方式是在色谱柱前安装一个柱前过滤器（或保护柱）。在绝大部分情况下，柱前过滤器可以帮助去除样品、流动相或者从液相系统（如泵或者进样密封圈）中浸出的残留颗粒。赛分科技柱前过滤器不含填料，因此不会改变分析物的保留时间，也不需要单独平衡。过滤器的滤芯是可以更换的，当压力升高时表明应更换滤芯。

色谱柱安装与操作

色谱柱在运输过程中或在没有使用时，它的两端总是用堵头进行密封。当将色谱柱接入色谱仪器系统时，首先移去两端的堵头。请注意将流动相流动的方向与柱上标记的方向保持一致。除非出于特殊考虑，例如为了清除堵在色谱柱入口端的脏污等而需要将色谱柱反接以进行冲洗时，建议用户在接上色谱柱时一定要遵循柱上标记的方向。由于色谱柱的连接是整个色谱操作过程的一部分，如果密封卡套过紧，或安装不合适，或者密封卡套与色谱柱端口不匹配，都有可能导致溶液的泄漏。请按照下面步骤将色谱柱与密封卡套相连接，从而将色谱柱接入 HPLC 系统：

(a) 第一次使用的管线，请依次将管线接头和密封卡套装在外径 1/16" 的管线上。密封卡套的宽口端应朝向管线接头。

(b) 将管线紧紧插入色谱柱的接口，向前滑动密封卡套和管线接头，并使管线接头的螺纹与色谱柱端口的螺纹相互衔接，然后拧紧管线接头。如果管线为高分子材料，请转到步骤 (d)；如果是金属管线，请继续 (c)。

(c) 在用力将管线压入柱端接口之后，用 1/4" 扳手将已拧紧的螺帽再进一步紧固。

(d) 对色谱柱的另一端采用上述方法进行操作。

色谱柱活化 在储存和运输中色谱柱填料可能会变干。为

了活化新的色谱柱，推荐采用 10-20 CV 的流动相用低流速冲洗色谱柱，再逐渐升高至预计的操作流速。下表中提供参考活化程序。如果您的流动相中含有超过 20% 的有机相，请先用 2-5 CV 纯水以低流速冲洗色谱柱再转换为含有机溶液流动相，以预防出现沉淀的情况。需要注意的是部分有机溶剂粘度/背压更高，如 IPA，EtOH，这时需要采用更低的流速。对于使用超过 20% 有机溶剂流动相，推荐在平衡时，采用低流速或者让流动相在色谱柱中过夜保存可以让填料更好的适应。对于水相使用，用流动相冲洗色谱柱，同时逐渐将流速增加到操作流速，使色谱柱压力平衡，并且基线稳定。）

下表中提供推荐起始流速。建议初始流速为 1/5 正常流速，每两到三分钟以 1/5 递增。监测基线和压力，每次增加流速后保证基线和压力稳定几分钟，再逐渐提高流速。如果加入有机溶剂，如 IPA，则需要减小增加的幅度。

Column Dimension (mm)	Column Volume (mL)	New Column Flow rate (mL/min)	Ramp up Increments (mL/min)	Running flow rate (mL/min)
2.1×300	1.04	0.01	0.01	0.07
4.6×300	4.99	0.05	0.05	0.35
7.8×300	14.34	0.1	0.1	1.0
10×300	24	0.3	0.1	1.65
21.2×300	105	1.4	0.5	7.5
30×300	212	2.8	1.2	15
50×300	490	7.8	3.5	41

流速范围 在常温环境下使用磷酸盐缓冲液作为流动相时，可以在上表中找到正常的操作流速。在低温环境中运行仪器或添加任何粘度高于水的溶剂可能会导致背压增加。应调整流速以确保背压不超过限值。流动相组成改变时需要逐渐调整流速，这样色谱柱的压力变化较小，减小色谱柱的损害。

运输溶剂 新色谱柱的运输溶剂为含 0.02% NaN₃ (w/v) 的 50 mM 磷酸盐缓冲液。

pH 为了获得最佳的分离效果和延长柱的使用寿命，请尽量使用 pH 在 2-7.6 范围内的流动相。最高可使用 pH 为 8.5，只能短时间内使用以获得最佳色谱柱寿命。建议在高或低 pH 条件下使用色谱柱后用中性 pH 缓冲液冲洗色谱柱。

压力 尽管 SRT-10 和 SRT-10C SEC 柱可在高至 3,000 PSI（孔径为 100-300 Å）和 2,000 PSI（孔径为 500-2,000 Å）

的压力下使用，但正常的操作压力应当低于 2,000 PSI。长时间在高压下运行会损坏色谱柱和输液泵。突然改变系统/泵压力也可能导致不可逆转的损坏。由于压力来源于流速，因此最大流速将受制于系统所能承受的压力。一般而言，柱压会随着色谱柱使用时间的增加而逐渐增加。压力突然增加预示色谱柱入口端的筛板发生了堵塞。在这种情况下，建议将色谱柱反接后用适宜的溶剂进行冲洗。

温度 最高操作温度为 80°C。为了获得最长的使用时间，最佳操作温度为 10-30°C。长时间在高温（>80°C）下操作也会损坏色谱柱，这种情形在高的 pH（>8）条件下特别明显。

关机程序 在工作日结束时，柱子平衡到适当的缓冲存储溶液中后，应逐渐降低流速。当流速和压力降至零，就可以将色谱柱从系统中取出。每根色谱柱都附带两个可拆卸的端塞。为防止柱床干燥，使用提供的端塞将两端密封。

储存 当色谱柱几天不使用时，应将其储存在低盐、pH 中性缓冲液中，例如 50 mM 磷酸盐缓冲液 pH 7.0。（如果您计划将色谱柱储存在有机溶液中，例如 10% EtOH，请务必先用水缓慢冲洗色谱柱以防止盐析，然后切换到较低流速的储存溶液，例如运行流速的一半速度。）

当色谱柱长时间不使用时，建议添加抑菌剂，例如 0.02% 叠氮化钠（NaN₃）或 20% 乙腈：

- 50 mM 磷酸盐缓冲液 pH 7.0，含 0.02% 叠氮化钠
- 或
- 50 mM 磷酸盐缓冲液 pH 7.0，含 20% 乙腈

由于 SEC 表面涂层在盐溶液和有机相中存在构象的差异，该现象会对分离产生差异性，建议用有机相保存的柱子在下次启用时，均需要低流速用水预先充分平衡，再用流动相平衡，以保持分离效果一致，同时也可更好的保护色谱柱。

日常预防性护理 对于日常预防性护理，在正常运行条件和流动相下单次进样 6 M 盐酸胍，可以在储存前去除任何可能粘在色谱柱上的残留成分，以延长色谱柱的使用寿命并抑制残留物与色谱柱填料的不可逆结合。请参阅下表，了解特定色谱柱尺寸的盐酸胍进样量参考。进样后，继续运行关闭程序和保存色谱柱。

Column Dimension (mm)	Column Volume (mL)	Guanidine HCl injection volume (μL)
4.6×300	4.98	20-50
7.8×300	14.3	100
10×300	23.5	240
21.2×300	106	1000

30×300	212	2200
50×300	490	4900

*在清洗前、后用去离子水过渡。

保护柱/柱前过滤器 建议使用保护柱或柱前过滤器以延长色谱柱寿命。如果您发现色谱柱压力增加，请立即更换保护柱/柱前过滤器。

PN	Description	Firt size
102000-P355	柱前过滤套	2.0 μm PEEK
102001-P355	柱前过滤套中滤片	2.0 μm PEEK
102020-21200	柱前过滤套	2.0 μm SS
102020-00001	柱前过滤套中滤片	2.0 μm SS

清洗 正确和定期的系统维护和清洁与色谱柱保养一样重要。在使用过程中，部分样品可能会吸附到入口筛板或填料上。当吸附积累到一定程度时，通常表现为背压升高并伴随峰形展宽。如果使用保护柱，请确保断开连接，单独清洗分析柱或制备柱。

通用的色谱柱清洗流程如下：

1. 断开色谱柱与检测器。
2. 对不锈钢色谱柱，将色谱柱反接后冲洗。
3. 逐渐增加流速进行冲洗，注意不要超过最大推荐流速的50%。对于粘度较高的有机溶剂，如 IPA 和 EtOH，建议至少使用 1/3 的运行流速。监测背压，确保在切换缓冲溶液时，压力读数增加不超过 15 bar。如果你看到压力差远远高于正常的操作条件，降低流速，以避免压力峰值对色谱柱造成更大的损害。
4. 通常情况下，用清洗溶液冲洗 5 倍柱体积即可。为了防止盐析或不同溶剂不能混溶的情况，需要在每次切换之间用 2-3 倍柱体积的蒸馏水、去离子水缓慢地冲洗柱子。

清洗溶液 低 pH 值的盐溶液有助于去除碱性蛋白质。有机物有助于去除疏水性蛋白质。离液盐有助于去除强烈吸附的物质（通过破坏氢键作用力）。只有在中性盐或有机物不能提高分辨率的情况下，才会使用离液盐。所有硅胶 SEC 柱，都容易受到腐蚀破坏；因而对于硅胶 SEC 色谱柱不应使用 NaOH 等溶剂。以下为推荐的两种清洗溶液：

- 低 pH 值（eg. pH 3.0）下的浓缩中性盐（eg. 0.5 M Na₂SO₄）。（适用于静电相互作用）
- 或
- 含水溶性有机溶剂（eg. 10-20%的甲醇、乙腈、乙醇等）的缓冲溶液（eg. 50 mM 磷酸盐缓冲液，pH 7.0）。

SRT-10/SRT-10C SEC 产品规格

（粒径均为 10 μm）

产品	内径×长度 mm×mm	孔径 Å	货号
SRT-10 SEC-100	7.8×300	100	225100-7830
SRT-10C SEC-100	7.8×300	100	239100-7830
SRT-10 SEC-300	7.8×300	300	225300-7830
SRT-10C SEC-300	7.8×300	300	239300-7830
SRT-10 SEC-500	7.8×300	500	225500-7830
SRT-10 SEC-1000	7.8×300	1000	225950-7830
SRT-10 SEC-100	21.2×300	100	225100-21230
SRT-10C SEC-100	21.2×300	100	239100-21230
SRT-10 SEC-300	21.2×300	300	225300-21230
SRT-10C SEC-300	21.2×300	300	239300-21230
SRT-10 SEC-500	21.2×300	500	225500-21230
SRT-10 SEC-1000	21.2×300	1000	225950-21230

*其他规格色谱柱产品及任何问题可致电：400-636-8880 或联系 marketing@sepax-tech.com.cn。